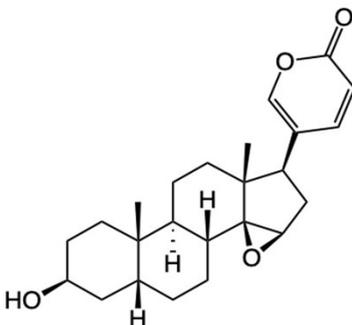
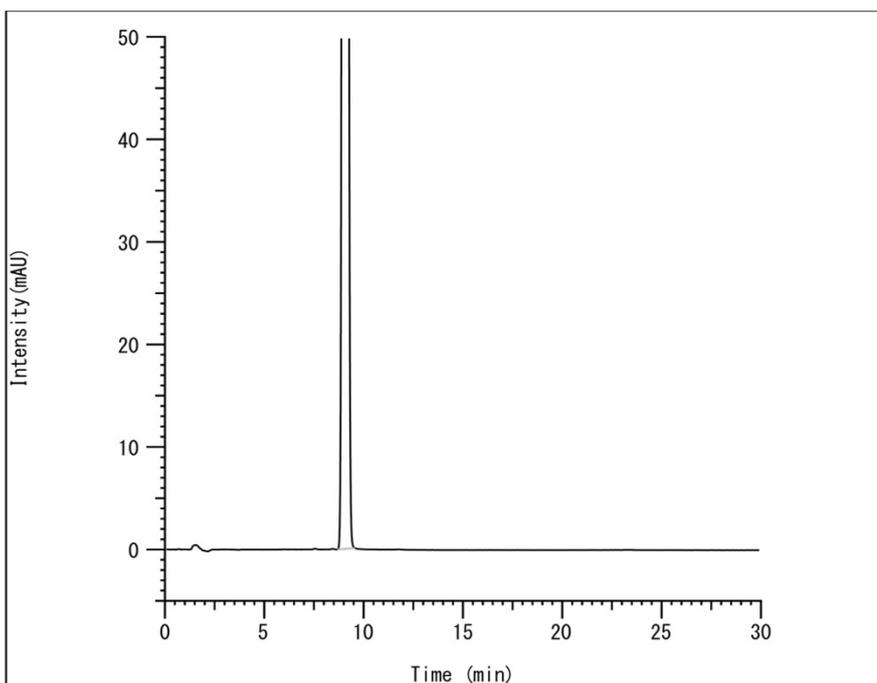


検査成績書

製品番号	42	品名	レジブフォゲニン Resibufogenin										
ロット番号	422401		容量	20mg									
検査年月日	2024年1月23日		保管条件	冷蔵 (10°C以下)									
			$C_{24}H_{32}O_4$ MW : 384.51 CAS RN: 465-39-4										
本品は、第18改正日本薬局方 試薬・試液の項「レジブフォゲニン，定量用」および「レジブフォゲニン，薄層クロマトグラフィー用」規格に適合する。													
含量 (98.0%以上)			適合 (100.0%)										
													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保持時間</th> <th>面積</th> <th>面積%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.067</td> <td>11629713</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>11629713</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>					保持時間	面積	面積%	9.067	11629713	100.00	Total	11629713	100.00
保持時間	面積	面積%											
9.067	11629713	100.00											
Total	11629713	100.00											
定量法 (HPLC)	検出器 : 紫外吸光光度計 (300nm) カラム : YMC-Pack ODS-AL (φ 4.6×250mm) カラム温度 : 40°C付近の一定温度 移動相 : 水/アセトニトリル混液 (1:1) 流量 : レジブフォゲニンの保持時間が約9分になるように調整する 面積測定範囲 : 溶媒のピークの後からレジブフォゲニンの保持時間の約2倍の範囲												

性状	適合
吸光度 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (300nm) : 131~145	適合 (138)
純度試験 類縁物質 (TLC)	適合
水分 (電量滴定による)	0.0%
使用上の注意 弊社が販売する生薬成分標準物質には有効期限を設定しておりません。すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用ください。	

岩嶋薬品株式会社

〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地

TEL : 052 (715) 5601 FAX : 052 (715) 5602